



НЕЙТРОНИК™

Средство индивидуальной
защиты от излучений

НЕЙТРОНИК™
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ №1

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ
И ПК РАСТЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ



Во всем мире насчитывается

более:

6 млрд. абонентов сотовой
челове связи

1 млрд. пользователей
челове ПК

До сей^к поры общественности не были
представлены результаты клинических
исследований, которые бы
подтверждали безопасность мобильных
средств связи и ЖК мониторов.


Из-за большого количества излучающих приборов
электромагнитный фон в современном городе
превышает нормальный уровень до

100 000 раз

НЕЙТРОНИК™

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ №1

ИЗЛУЧЕНИЕ ТВОЕГО СОТОВОГО —
ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ

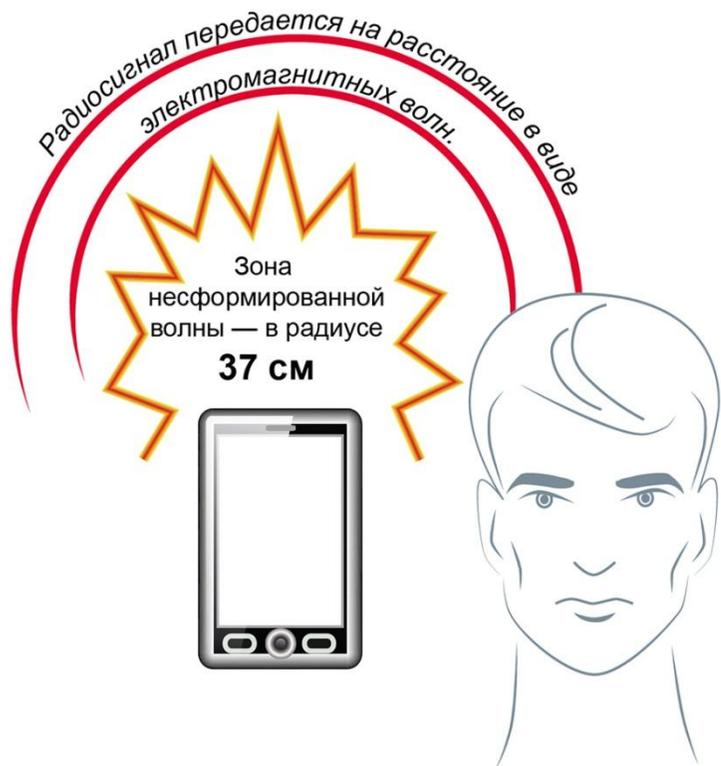

Несмотря на заверения производителей, многие специалисты убеждены в том, что воздействие волн, излучаемых трубкой, может вызвать тяжелые заболевания.

«Если наши предположения верны, то нынешняя молодежь, весьма интенсивно пользующаяся мобильными, столкнется с болезнями Альцгеймера и Паркинсона уже в возрасте Христа» (проф. Лейв Селфорд, нейрохирург, Швеция).


В зоне несформированной волны устанавливается нестабильный режим излучения. Он может превышать допустимые нормы **до нескольких десятков раз.**

НЕЙТРОНИК™


УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ №1

ОРГАНИЗМ РЕАГИРУЕТ НА ИЗЛУЧЕНИЕ МОНИТОРА,
КАК НА ПРИЕМ ЯДА

Современные мониторы имеют крайне низкую мощность излучения, и поэтому считаются безопасными. Их вредность выявляется только при биологическом тестировании. Например, при исследовании реакции микроорганизмов.

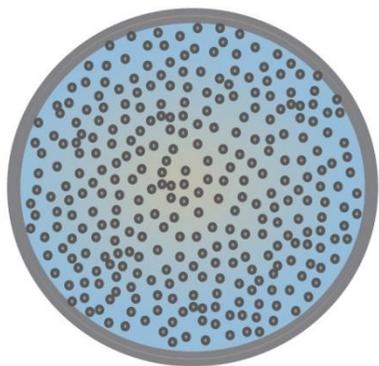

Микроорганизмы
в нормальном
состоянии

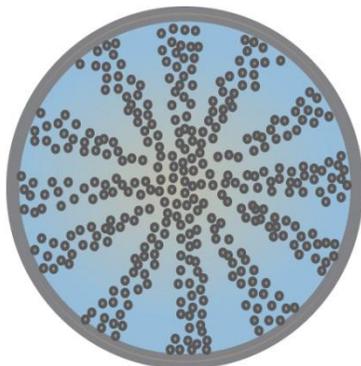

Микроорганизмы
под воздействием
излучения



Микроорганизмы в чашке Петри под воздействием излучения в зоне до 2 м от экрана образуют паттерны. Такие же паттерны образуются при добавлении в чашку токсиканта.

Установить треугольником вниз

В 2011 году специалисты Всемирной организации здравоохранения признали излучение мобильных телефонов потенциальным канцерогеном, наряду с инсектицидом (ДДТ), свинцом, бензином и дизельным топливом.

Регулярное использование сотовых телефонов без защитных устройств повышает риск развития онкологии, вызывает снижение иммунитета, дисфункции нервной, половой, сердечно-сосудистой и других систем организма.



НЕЙТРОНИК™

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ №1

МОДЕЛЬ МГ-03
СМАРТФОН

НЕЙТРОНИК™

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ №1

МОДЕЛЬ МГ-04М

МОНИТОР КОМПЬЮТЕРА И ТЕЛЕВИЗОР



Установить в левый нижний угол экрана




Во всем мире насчитывается более 1 миллиарда компьютеров. Современные мониторы имеют крайне низкую мощность излучения и поэтому считаются безопасными. Их вредность выявляется только при биологическом тестировании. Например, при исследовании реакции микроорганизмов.

НЕЙТРОНИК™

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ №1

МОДЕЛЬ МГ-03 + МГ-04М
ПЛАНШЕТ

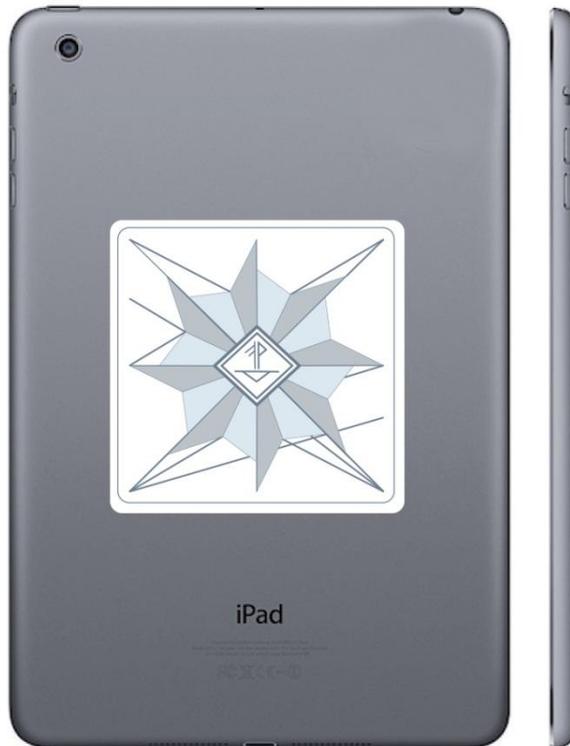

Планшетный компьютер, удобный аксессуар современного делового человека, представляет двойную угрозу здоровью: как источник излучения при использовании беспроводной связи (Wi-Fi, мобильный интернет) и как устройство с ЖК дисплеем.


НЕЙТРОНИК™

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ №1

МОДЕЛЬ МГ-04М
НОУТБУК



Установить в левый нижний угол экрана

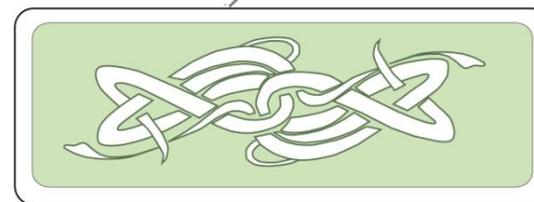

Современные дети пользуются сотовыми телефонами, компьютерами и ноутбуками наравне со взрослыми. При этом детский организм значительно чувствительнее к их вредному воздействию.


НЕЙТРОНИК™

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ №1

МОДЕЛЬ МГ-03
РОУТЕР



Установить треугольником вниз

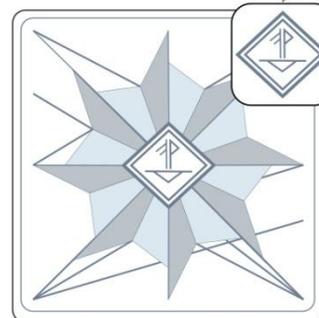


Воздействие Wi-Fi волн на организм человека до сих пор не изучено. По словам отечественных исследователей последствия неконтролируемого использования данного вида связи будут очевидны только через поколение.

В то же время датские ученые уже обратили внимание на то, что Wi-Fi излучение вредно сказывается на сосудах головного мозга. А российские ученые заявляют о возможном вреде для мужской половой системы.

НЕЙТРОНИК™

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ №1

СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ
ПОЛЯ ИЗЛУЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

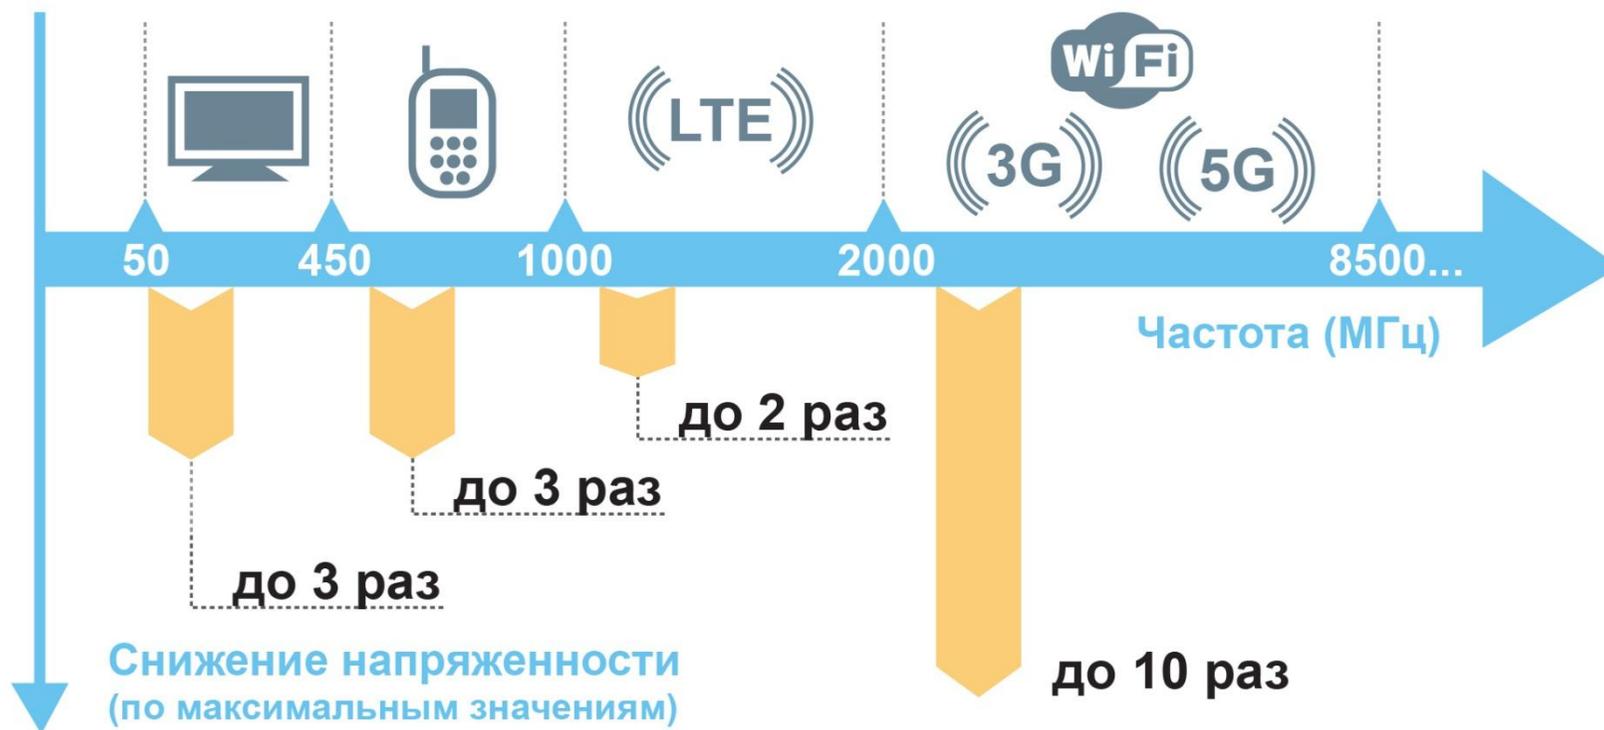


Ослабление поля на разных частотах регистрируется с использованием стенда измерения напряженности ЭМП (ОАО "Научно-исследовательский институт особо чистых материалов", протокол № 23 от 18 марта 2016 г.).


НЕЙТРОНИК™

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
ОТ ИЗЛУЧЕНИЙ №1

СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

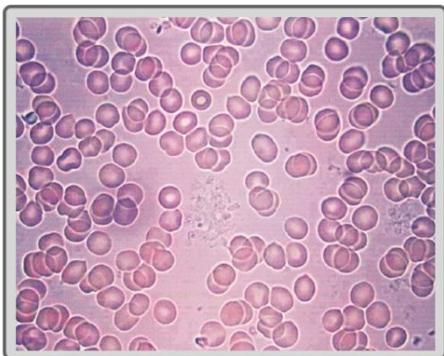

Исходное
состояние крови
(без телефона)

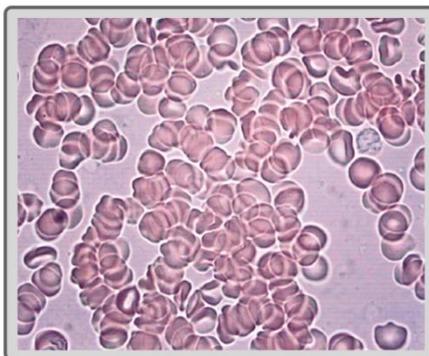

Эритроциты крови
слипаются после
1 минуты разговора



После установки НЕЙТРОНИКА™
кровь приходит
в исходное состояние

Под воздействием излучения телефона происходит слипание эритроцитов крови, что в свою очередь приводит к кислородному голоданию. Использование НЕЙТРОНИКА™ позволяет снизить воздействие излучения на организм и избежать развитие патологий.

НЕЙТРОНИК™
ЗАЩИТИ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ

